＊＊2008 年 3 月 28 日作成(第4 版)
＊2007 年 5 月 22 日作成(第3版)

＊届出番号 11B1X00002Z01008

機械器具(1)手術台及び治療台
一般医療機器 分娩台 13960000

# アトム分娩台 DE-3500

**【警 告】**

使用方法

●本器の駆動範囲内に人がいたり機器類があると危険です。
駆動させる場合は、安全を確認してから操作してください。
［駆動範囲内に障害物があると、破損やけがの原因になります。］

●本器を操作する場合、産婦の反応に気を配り、周囲の安全を確認してください。
［けがの原因になる恐れがあります。］

**【禁忌･禁止】**

使用方法

●高周波を発生する機器を、本器の周辺で使用しないこと。
［医用電気メスや携帯電話等の高周波を発生する機器を、本器の作動中に周辺で使用すると、電波障害による誤作動の原因になります。］

## 【形状･構造及び原理等】

### 1. 各部の名称

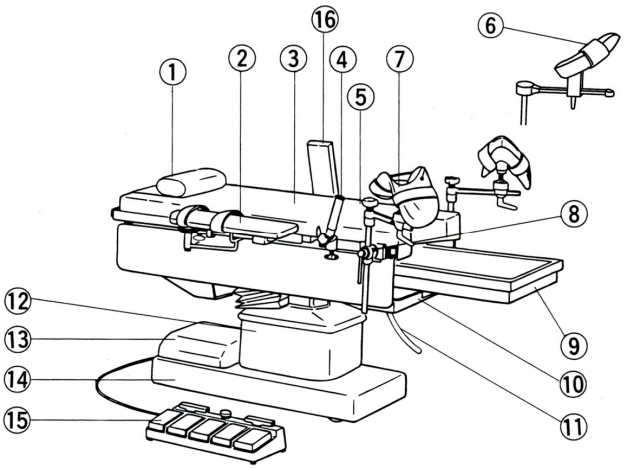


| 番号 | 名 称 | 番号 | 名 称 |
|---|---|---|---|
| ① | 枕 | ⑨ | 補助台 |
| ② | サイド台 | ⑩ | 汚水ロート |
| ③ | 背板 | ⑪ | 排水ホース |
| ④ | 怒責グリップ | ⑫ | 昇降用スライドカバー |
| ⑤ | 腰板 | ⑬ | メンテナンスカバー |
| ⑥ | 踵受(1) | ⑭ | ベースカバー |
| ⑦ | 股受(2) | ⑮ | フットスイッチボックス |
| ⑧ | 支脚固定器 | ⑯ | 胴 受 |

(1)組合せⅠおよび組合せⅢに装備されています。
(2)組合せⅡおよび組合せⅢに装備されています。
※詳細は取扱説明書の第2章を参照してください。

### ＊＊2. 寸法･重量

(1) テーブル／寸法：幅 50　奥行 122cm
(2) 補助台／寸法：幅 47　奥行 58cm
(3) 重量：250kg

### ＊＊3. 原 理

手術台で電動油圧式の駆動をする。

## 【使用目的、効能又は効果】

### ＊＊1. 概要

本器は、電動または電動油圧式の駆動源を有する手術台です。

## ＊＊【品目仕様等】

### ＊＊1. 機器の分類

保護の形式：クラスⅠ機器　保護の程度：B 形装着部
デューティーサイクル：最大駆動時間 60 秒間
停止時間 120 秒以上

### ＊＊2. 電気的定格

定格電圧：AC100V　消費電力：800VA/600VA
周波数 50/60Hz 共用
動作電圧範囲：AC100V±10%
**※本製品は EMC 規格 JIS T0601-1-2:2002 に適合しています。**

## 【操作方法又は使用方法等】

### 1. 使用環境条件

(1) 温度：10～40℃
(2) 湿度：30～75%（結露しないこと）
(3) 気圧：70～106kPa

### 2. 操作方法　※詳細は取扱説明書を参照してください。

(1) 電源スイッチをＯＮにする。
(2) フットスイッチにて台の昇降、腰板の昇降、背板の昇降、補助台の前側昇降を行う。
(3) 補助台全体昇降スイッチのワンタッチ操作で、補助台全体の引き出し上昇及び下降収納を自動的に行います。
(4) フットスイッチの水平復帰スイッチを押すと、縦転位および横転位を自動的に水平位に復帰します。

## 【使用上の注意】　※詳細は取扱説明書を参照してください。

(1) 本器の設置は、確実にストッパーをかけて固定すること。
［転倒や移動などして、破損やけがの原因になります。］
(2) 本器の動作電圧範囲(AC100V±10%)外では使用しないこと。
(3) 電源コンセントの位置は、本器の近くで電源コードに人が触れない位置を選び、機器 1 台ごとに専用のコンセントを用いること。また、アースを確実にとるために、電源コードは正しくアースされた 3 芯接地型コンセントだけに接続すること。

**取扱説明書を必ずご参照ください。**

(4) 絶対に延長コードを使用しないこと。
(5) 本器が正常に動作しないときは、すぐに使用を中止すること。
(6) 本器を布などで覆った状態で使用しないこと。
［加熱して火災や感電の原因になります。］
(7) 台を昇降や傾斜させるとき、昇降や傾斜範囲内の安全を充分確認してから操作すること。
［けがや故障の原因になります。］
(8) 補助台の作業中には、補助台に手を触れないこと。
［手が挟まれる恐れがあります。］
*(9) 補助台の動作中は、補助台が踵受または股受と接触しないことを常に確認すること。
［破損の原因になります。］
(10) 背板を起倒させるときは、起倒範囲内の安全を充分確認すること。
［けがや破損の原因になります。］
(11) 股受等を使用する場合は、クイックロックレバーが確実にロックされていることを確認すること。
［けがの原因になります。］
(12) 分解や改造をしないこと。
［火災や感電、けがの原因になります。］

**【貯蔵･保管及び使用期間等】

1. 保管条件

周囲温度：－10～60℃
相対湿度：10～85％（結露しないこと）
気　　圧：70～106kPa

2. 耐用期間

本器の耐用期間は 6 年です。［自己認証データによる］

**【保守･点検に係る事項】**

本器を安全に、より長い間ご使用いただくために、「使用前の点検」、「3 ヵ月毎の点検」、を実施してください。
また、定期的に交換が必要な部品があります。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】**

**■製造販売業者**

**アトムメディカル株式会社**
〒338-0835 埼玉県さいたま市桜区道場 2-2-1
TEL: 048-853-3661(大代表)　FAX: 048-853-0304(代表)

**■製造業者**

**アトムメディカル株式会社**
〒113-0033 東京都文京区本郷 3-18-15
TEL: 03-3815-2311(大代表)　FAX: 03-3812-3144(代表)